



充電式 Inzio Charge&Go IX専用注文書 2026年4月版



●この注文書は充電式の注文書となります。
電池式のご注文は
『INSIO IX 専用注文書』をご利用ください

ご依頼日 年 月 日

※Inzio Charge & Go IXは電池式より+1日の納期が掛かります。

お取扱店情報

貴店コード	C18	※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名	様	
TEL	FAX	
ご担当者名	様	

直送先情報 ※登録の送付先と異なる場合 ※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名	様
〒	
直送先住所	
TEL	

お客様情報 ※ご記入の氏名が保証書に印字されるため、正確にご記入ください。解読不明、印字不可能な漢字は保証書に印字いたしかねます。ご了承ください。

フリガナ
お名前 様 才 男 女

■耳の状態 普通 軟らかい 硬い しわ耳

■ご使用中の補聴器 両耳 左 右 メーカー: _____

器種名: _____ シリアル: _____

■オーディオグラム

■語音明瞭度
左: % ・ 右: %

▼Step1: 器種選択とカラー選択 _____ 項目は必須選択

INSIO Charge & Go IX	クラス	マトリクス	シェル/FPカラー	シェルマーキング※			取り出し用コード	シェルグリップ
				青	赤	白		
7 5 3 2 1	ノーマル 113/50	左 右	シェル: モカ FP: モカ	左 CD	右 CD	-	標準 7mm	左 右 P1 P1
	ハイパワー 124/60	左 右	シェル: ブラック FP: ブラック	-	-	左 SM 右 SM		

※ブラックの場合、シェルマーキングは片耳のみの選択をお勧めします。

▼Step2: ベント選択

タイプ	サイズ
{左}{右} 溝ベント	{左}{右} 1.0mm
{左}{右} Dベント	{左}{右} 1.5mm
{左}{右} なし	-

※ご記入がない場合はメーカーおまかせ

▼Step3: その他選択

■刻印用カナ

※カタカナ6文字まで。
左右別々はできません。
濁点半濁点は1文字にカウントしません。

■充電器(有料)

充電器 21048779	標準	不要
-----------------	----	----

※充電器が不要な場合、不要の点線囲みに○をつけてください。

■ワックスガード

クイックガードのみ


■アクセサリ(有料)

{ミニポケット} 10939860 {パーフェクトドライラックス} 10941021 {パーフェクトドライクイックエア} 10941020 {ドライキャップUV2.1} 10997993

特記事項

小さい仕上がりを希望される方へのご注意


右図のようにInzio Charge&Go IX CICには、高速演算処理+充電を司る内部ユニットとレシーバーユニットが入ります。耳型により入るスペースがない場合は、外耳道入口より外側にフェイスプレートが来ますので予めご注意ください。

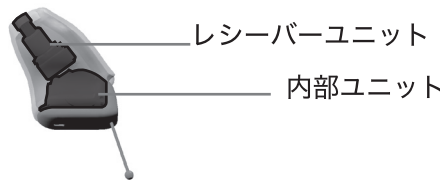

①～④の順に測定します。

耳型条件1: 長さ

- ② ①の終点～鼓膜側先端: 8mm
- ① 外耳道入口～第1カーブ付近: 9mm

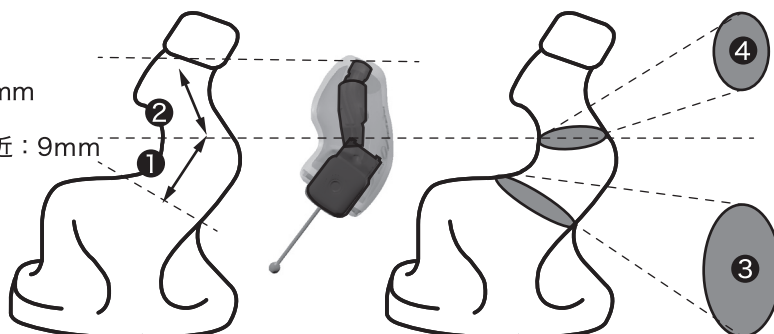

耳型条件2: 太さ

- ④ 第1カーブ付近の太さ
 - ①の終点の太さを測ります。
 - ノーマル: 5.0 × 7.0mm
 - パワー: 5.0 × 8.2mm
 - ハイパワー: 6.2 × 8.2mm
- ③ 外耳道入口の太さ: 7 × 14mm

※ベントを選択した場合、耳型の曲がりがかたい場合、鼓膜方向先端が細い場合は、上記の条件に当てはまっても外耳道入口より外側にフェイスプレートが出る可能性がございます。



充電式 Inzio Charge&Go IX専用注文書 2026年4月版



●この注文書は充電式の注文書となります。
電池式のご注文は『INSIO IX 専用注文書』をご利用ください

お客様情報 ※ご記入の氏名が保証書に印字されるため、正確にご記入ください。解読不明、印字不可能な漢字は保証書に印字いたしかねます。ご了承ください。

ご依頼日 年 月 日

※Inzio Charge & Go IXは電池式より+1日の納期が掛かります。

お取扱店情報

貴店コード	C18	※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名	様	
TEL	FAX	
ご担当者名	様	

直送先情報 ※登録の送付先と異なる場合 ※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名	様
〒	
直送先住所	
TEL	

フリガナ
お名前 男 女
様 才

■耳の状態 普通 軟らかい 硬い しわ耳

■ご使用中の補聴器 両耳 左 右 メーカー: _____

器種名: _____ シリアル: _____

■オーディオグラム

■語音明瞭度
左: % ・ 右: %

▼Step1: 器種選択とカラー選択 _____ 項目は必須選択

INSIO Charge & Go IX	クラス	マトリクス	シェル/FPカラー	シェルマーキング※			取り出し用コード	シェルグリップ
				青	赤	白		
7 5 3 2 1	ノーマル 113/50	左 右	シェル: モカ FP: モカ	左 CD	右 CD	-	標準 7mm	左 右 P1 P1
	パワー 118/55	左 右						
	ハイパワー 124/60	左 右	シェル: ブラック FP: ブラック	-	-	左 SM		

※ブラックの場合、シェルマーキングは片耳のみの選択をお勧めします。

▼Step2: ベント選択

タイプ	サイズ
{左}{右} 溝ベント	{左}{右} 1.0mm
{左}{右} Dベント	{左}{右} 1.5mm
{左}{右} なし	-

※ご記入がない場合はメーカーおまかせ

▼Step3: その他選択

■刻印用カナ

※カタカナ6文字まで。左右別々はできません。濁点半濁点は1文字にカウントしません。

■充電器(有料)

※
充電器
21048779
標準 不要

※充電器が不要な場合、不要の点線囲みに○をつけてください。

■ワックスガード

クイックガードのみ


■アクセサリ(有料)

{ミニポケット} {パーフェクトドライラックス} {パーフェクトドライクイックエア} {ドライキャップUV2.1}

特記事項

小さい仕上がりを希望される方へのご注意


右図のようにInzio Charge&Go IX CICには、高速演算処理+充電を司る内部ユニットとレシーバーユニットが入ります。耳型により入るスペースがない場合は、外耳道入口より外側にフェイスプレートが来ますので予めご注意ください。

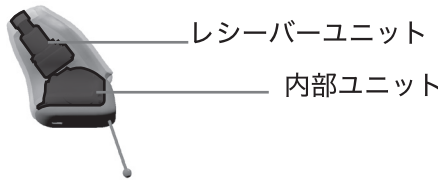

①～④の順に測定します。

耳型条件1: 長さ

- ② ①の終点～鼓膜側先端: 8mm
- ① 外耳道入口～第1カーブ付近: 9mm

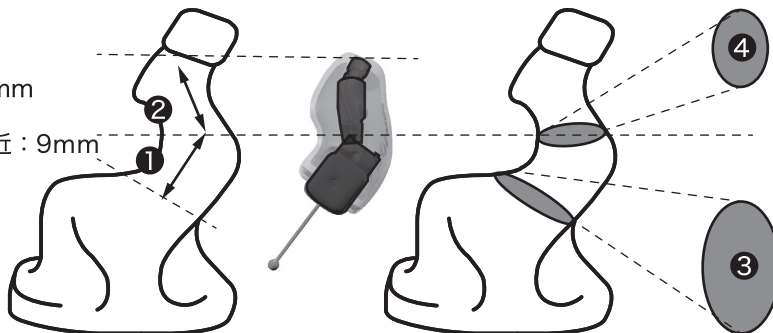

耳型条件2: 太さ

- ④ 第1カーブ付近の太さ
 - ①の終点の太さを測ります。
 - ノーマル: 5.0 × 7.0mm
 - パワー: 5.0 × 8.2mm
 - ハイパワー: 6.2 × 8.2mm
- ③ 外耳道入口の太さ: 7 × 14mm

※ベントを選択した場合、耳型の曲がりがかたい場合、鼓膜方向先端が細い場合は、上記の条件に当てはまっても外耳道入口より外側にフェイスプレートが出る可能性があります。

オーダーメイド補聴器 オプション一覧

■カスタムオプション



取り出しコード (テグス)
目立たない標準タイプ



シェルマーキング
シェル上部にカラーマーキングを施します。シェルカラーがベージュ以外の選択時はマーキングが白になりますので、左右どちらかの選択を推奨します。



シェルグリップ
シェル表面に網目加工をすることで耳の中でズレにくくなります。主にIICやCICで顎関節がよく動く方に。

■ベントタイプ



溝 (トレンチ)
耳閉感を軽減します。耳道の細い方向向けです。
※サイズ優先のIICでは標準です



Dベント
アルファベットの「D」のような形状のベント。ベントチップは使用できません。限られたスペースに配置する事に向いています。



ベント無し
音量感を重視する方に。

個人情報の取り扱いについて

- 1.WSオーディオロジージャパン株式会社(以下「当社」)は個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令、当社プライバシーポリシー及び社内規程等を遵守し、当社で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。
- 2.当社はお客様から以下の情報をご提供いただいております。
 - ・氏名、年齢、性別
 - ・聴力データ
 - ・採形された耳型データ
 - ・補聴器の使用歴と使用器種に関するデータ
 - ・耳型作製において必要な範囲の手術・傷病歴
- 3.上記2の個人情報は、補聴器及びイヤモールド販売または修理の際の、販売店によるオーダーメイド注文書及びイヤモールド注文書の記入と耳型採型により、当社と販売店での共同利用として収集しております。共同利用の詳細は、販売店がお客様より個人情報をご提供いただいた際にお知らせしているとおります。
- 4.当社はお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内において使用し、お客様の同意なく、目的外の利用を行うことはありません。
 - ・オーダーメイド耳あな型補聴器の製作
 - ・イヤモールドの製作
 - ・上記の修理
 - ・販売店との間の連絡調整
- 5.お客様からご提供いただいた個人情報は厳重に取扱い方法を規定し、それに基づいた取扱いを徹底します。また内容訂正や利用停止等についてお客様の申請があった場合にはその申請に基づき、速やかに処理します。